


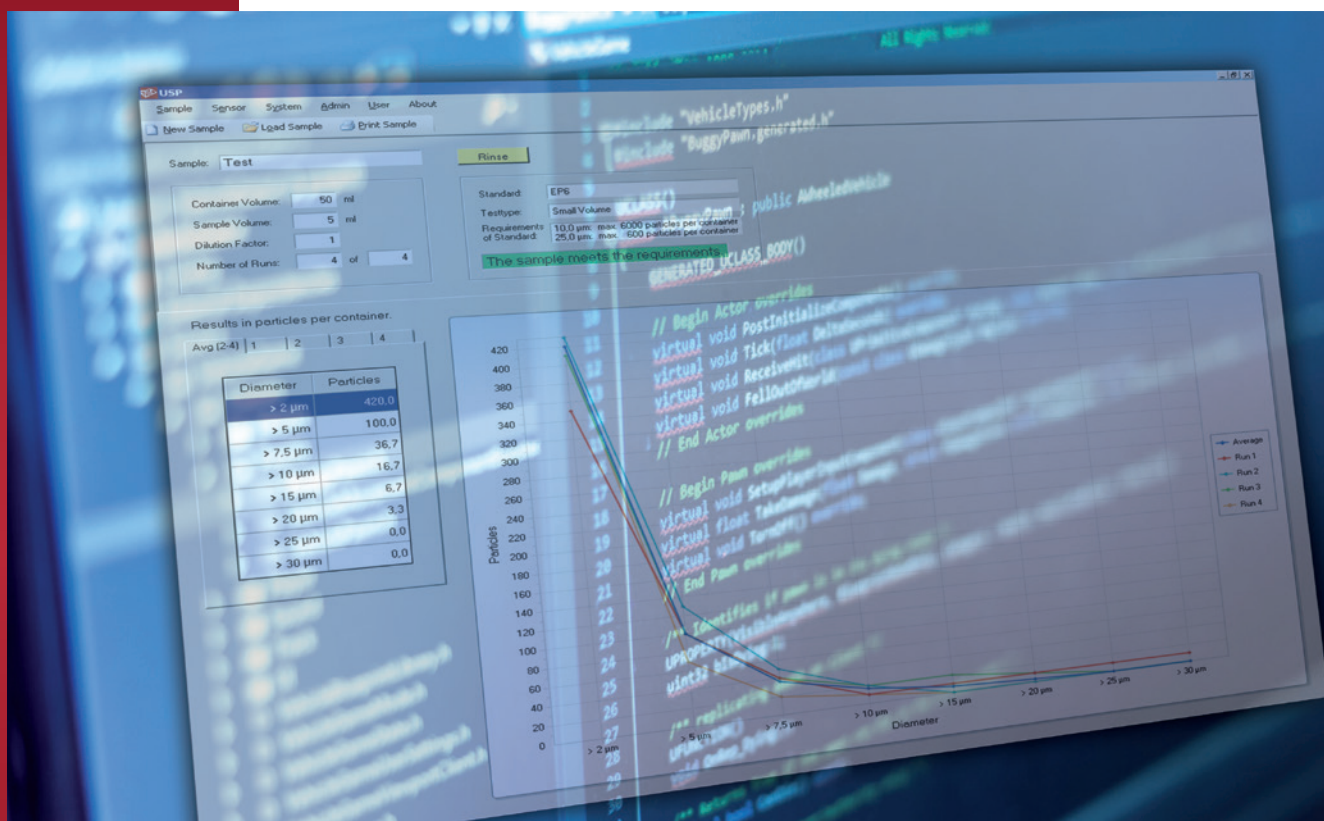

PAMAS USP

Logiciel pour applications pharmaceutiques

Mesures des particules en accord avec les standards USP <787>, USP <788>, USP <789>, EP, BP, JP, KP et IP ou selon les standards spécifiques du client

- Logiciel pour la mesure des solutés d'infusions, parentérales et fluides similaires selon les standards pharmaceutiques
- Peut être utilisé avec les compteurs laboratoires PAMAS SBSS et PAMAS SVSS
- Rapport numérique et graphique des comptages de particules cumulés en conformité avec les normes pharmaceutiques USP <787> (subvisible particules en thérapeutiques protéiques injections), USP <788> (particules en injections) et USP <789> (particules dans les solutions ophtalmiques) ainsi que d'autres pharmacopées nationales, y compris EP, JP, KP, BP et IP
- Fonction supplémentaire: Étalonnage du capteur
- Support pour IQ (qualification d'installation) et OQ (qualification de fonctionnement) pour la validation des compteurs de particules
- Compatible avec Microsoft Windows® 10 et 11



PAMAS USP

Logiciel pour applications pharmaceutiques



Avec le logiciel, les compteurs de particules laboratoire PAMAS SVSS et PAMAS SBSS effectuent des mesures dans le respect des normes pharmaceutiques de l'USP <787>, USP <788>, USP <789> et d'autres pharmacopées telles que EP, BP, JP, KP et IP.

Avec l'aide du logiciel PAMAS USP, les compteurs de particules PAMAS SVSS et PAMAS SBSS peuvent également être validés pour des applications pharmaceutiques.



Le système d'analyse PAMAS SVSS est un compteur de particules laboratoire pour les applications pharmaceutiques et autres liquides de faible viscosité.




L'appareil de mesure PAMAS SBSS est un compteur de particules pour échantillons de viscosité élevée.

Spécifications

- Entrée simple des données pour les nouvelles normes pharmaceutiques
- Les normes spécifiques des clients peuvent être définies
- Stockage des données et impression de tous les paramètres de mesure, y compris l'opérateur, la configuration des mesures, les résultats de mesure uniques et la valeur moyenne
- Définition facultative du facteur de dilution
- Chemin de mémorisation automatique des données sur une connexion sélectionnable (réseau)
- Exportation des données de mesure des résultats dans Microsoft Excel

Conforme à la norme 21 CFR Part 11 par

- Contrôle d'accès par mot de passe
- Les mesures peuvent être examinées et approuvées (signature électronique).
- Stockage des données dans la base de données cryptées

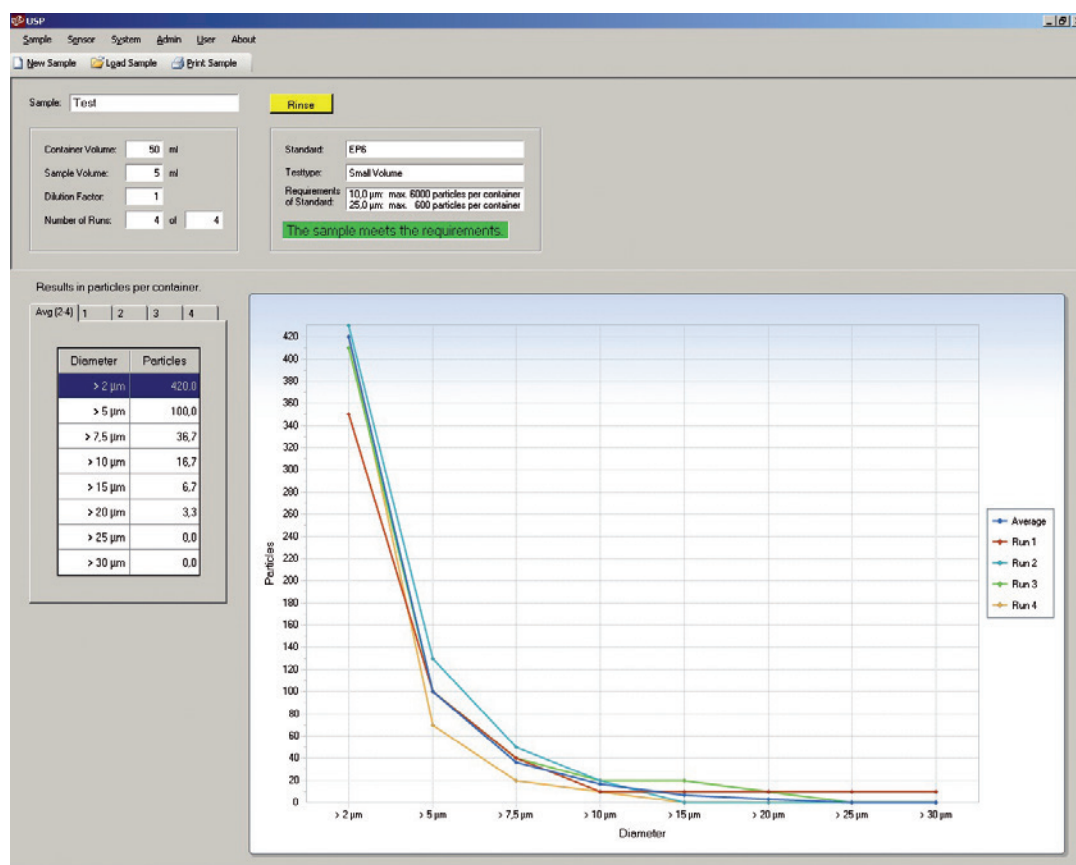

Si l'échantillon est conforme aux exigences de propreté de la norme choisie, le résultat de la mesure sera marqué en vert



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105038017